

Altéma kódszáma: 204105/03563

Pályázati cél: Állományvédelmi, restaurálási munkákhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése az MNM Palóc Múzeuma gyűjteményeinek elhelyezéséhez

Megvalósítás időtartama: 2020. november 1. – 2021. augusztus 31.

Megvalósítás helyszíne: MNM Palóc Múzeuma, Balassagyarmat, Palóc liget 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Múzeumunkban őrzött műtárgyak hosszú távú, állagóvó megőrzése szempontjából kulcsfontosságú műtárgyvédelmi feladatok ellátásához, a megelőzés, konzerválás, állapotmegóvás munkafolyamataihoz szükséges mérőműszerek, páramentesítő berendezések, a műtárgyak elhelyezéséhez megfelelő csomagoló anyagok, tároló eszközök, dobozok és dossziék beszerzése az eredeti pályázati célkitűzésünk szerint megvalósult. Ezekkel a speciális műszerekkel és berendezésekkel, csomagoló anyagokkal immáron megfelelő környezetet tudunk biztosítani műtárgyállományunk egy jelentős részének tárolásához és kiállítási bemutatásához.

Az elnyert támogatás segítségével beszerzett szakmai anyagokkal és állományvédelmi eszközökkel az allábiakban részletezett állományvédelmi feladatokat látjuk el:

Állományvédelmi anyag vagy eszköz megnevezése, tulajdonságai	Mennyiség (db)	Hasznosulás
Elsec 765 C kombinált mérőműszer	1	A hőmérséklet és a páratartalmon értékein kívül a fényt és az ultraibolya sugárzást is mérni képes készülék elsősorban a kiállítások készítésénél, műtárgy kölcsönzésnél, raktár kialakítási és ellenőrzési feladatok ellátása során hasznosul. A készülék segítségével fel tudjuk mérni a múzeum kiállítótereiben és raktáraiban az esetleges problémákat és ehhez mérten további intézkedéseket tudunk végrehajtani a műtárgyak állapotának védelme érdekében.
Trotec BL 30 Páratartalom és hőmérséklet adatrögzítő	3	A BL 30 hőmérséklet és páratartalom adatrögzítő egy magasprecízitású készülék, amely egyben gyors reakcióidővel rendelkezik. A mérőműszereket a múzeum kiállítótereiben és a külső raktáraiban, a kiállított és a tárolt műtárgyak környezetének mérésére, adatgyűjtésre egyaránt használjuk. Az adatrögzítővel egybeépített mérő készülékek a mérést meghatározott időközönként elvégzik, tárolják, a mérési értékeket számítógép segítségével kiértékeljük. Az adatok birtokában fel tudjuk mérni és beállítani a raktár, illetve a kiállítóhely

		optimális hőmérsékletét és pára tartalmát egyéb készülékek alkalmazásával (páramentesítő, párasító készülék) a különböző típusú és anyagszerkezetű tárgyak számára.
Trotec BZ 05 Páratartalom és hőmérséklet mérő	4	A mérőműszereket a múzeum kiállítótereiben és a külső raktáraiban, a kiállított és a tárolt műtárgyak környezetének mérésére használjuk.
Trotec TTK 72 E Páramentesítő készülék	4	A páratlanító berendezések, a műtárgyak optimális körülményeihez képest jellemzően magas relatív páratartalommal és hőmérsékleti értékekkel bíró műtárgyraktárainkban (a múzeumépület padlásterében kialakított modulrendszerű raktárak, könyvtár), kilátóhelyeinken (pl. lapidáriumi kiállítótér, történeti állandó kiállítás) hasznosulnak. A mobil készülékek szükség szerint áthelyezhetők.
Savmentes selyempapír csomagoláshoz	2	Fehér selyempapír tekercsben, természetes kalcium-karbonáttal dúsítva (GCC), pH értéke 8-9,5. Savmentes és nem tartalmaz semmilyen optikai fehérítő anyagokat (OBA-free). Elsősorban csomagolásra, képek, fényképek, akvarellek, grafikák, textíliák megóvására használjuk.
Archiváló doboz TYP/II/130	200	A magyar levéltári szabványnak megfelelő, savmentes környezetet biztosító, a dokumentumok hosszútávú megőrzésére szolgáló tárolóeszközök alkalmazásával az irodalomtörténeti gyűjtemény dokumentumanyagának és a néprajzi adattár anyagának állományvédelmi szempontú elhelyezése vált megoldottá.
Archiváló doboz TYP/II/450	50	A magyar levéltári szabványnak megfelelő, savmentes környezetet biztosító, a dokumentumok hosszútávú megőrzésére szolgáló tárolóeszközök alkalmazásával az irodalomtörténeti gyűjtemény dokumentumanyagának és a néprajzi adattár anyagának állományvédelmi szempontú elhelyezésére.
NP 520S újságpapír doboz	2	Az irodalomtörténeti gyűjtemény dokumentumanyagának anyagának elhelyezését biztosítja.

Tároló doboz TYP I/3x75	5	Az irodalomtörténeti gyűjtemény dokumentumanyagának anyagának elhelyezését biztosítja.
FILLA tároló (10x15cm) 4 zsebes	200	A lefűzhető tárolólapokkal a történeti gyűjtemény eredeti, forrásértékű fotóanyagának (800 db) elhelyezésére nyújt szakszerű megoldást.
Panoráma I. albumlap (6x9cm) 9 zsebes	100	A lefűzhető albumlapokkal a történeti gyűjtemény eredeti, forrásértékű fotóanyagának (900 db) műtárgyvédelmi normáknak megfelelő elhelyezését biztosítjuk.

A szakmai beszámoló internetes elérhetősége:

<https://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/szakmai-beszamolok/>

Alkalmazott kódok: 204105/03563
Alkalmazott cél: Állományvédelmi, restaurálási munkához szükséges anyagok, eszközök beszerzése az MNM Pálóc Múzeuma gyűjteményeinek elhelyezéséhez
Megvalósítás időtartama: 2020. november 1. – 2021. augusztus 31.
Megvalósítás helyszíne: MNM Pálóc Múzeuma, Balassagyarmat, Pálóc liget 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Múzeumunkban fennelt műtárgyak hosszú távú, állandó megőrzése szempontjából kiemelt fontosságú a műtárgyvédelmi feladatok ellátásához, a megelőzés, konzerválás, állapotmegőrzés munkafolyamataival szakszerű mérőműszerek, páramentesítő berendezések, a műtárgyak elhelyezéséhez megfelelő csomagoló anyagok, tároló eszközök, dobozok és dosztók beszerzése az eredeti pályázati célkitűzésünk szerint megvalósult. Ezekkel a speciális műszerekkel és berendezésekkel, csomagoló anyagokkal immár megfelelő környezetet tudunk biztosítani műtárgyállományunk egy jelentős részének tárolásához és kiállítás bemutatásához.



Az elnyert támogatás segítségével beszerzett szakmai anyagokkal és állományvédelmi eszközökkel az alábbiakban részletezett állományvédelmi feladatokat látjuk el:

Állományvédelmi anyag vagy eszköz megnevezése, tulajdonságai	Mennyiség (db)	Hasznosítás
Elsec 765 C kombinált mérőműszer	1	A hőmérővel és a páratartalom érzékelővel a fényt és az ultrahang sugárzást is mérni képes készülék elsősorban a kiállítások készítésénél, műtárgy kiállításánál, raklap kialakításánál és ellenőrzésénél feladatunk ellátása során használjuk. A készülék segítségével fel tudjuk mérni a múzeum kiállításait és raklapjait az esetleges problémákat és ehhez mérten további intézkedéseket tudunk végrehajtani a műtárgyak állapotának védelme érdekében.
		A BL 30 hőmérővel és páratartalom érzékelővel egy magasprecíziós készülék, amely egyben gyors reakcióidővel rendelkezik. A mérőműszereket a múzeum kiállításait védelme...




FOTÓMELLÉKLET:

A BESZERZETT ÁLLOMÁNYVÉDELMI ANYAGOK,
ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MŰTÁRGYKÖRNYEZETBEN



1. TROTEC BL 30 PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

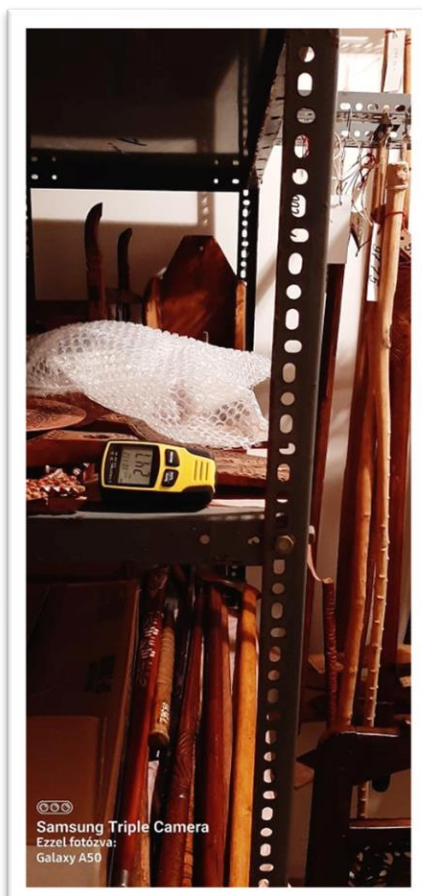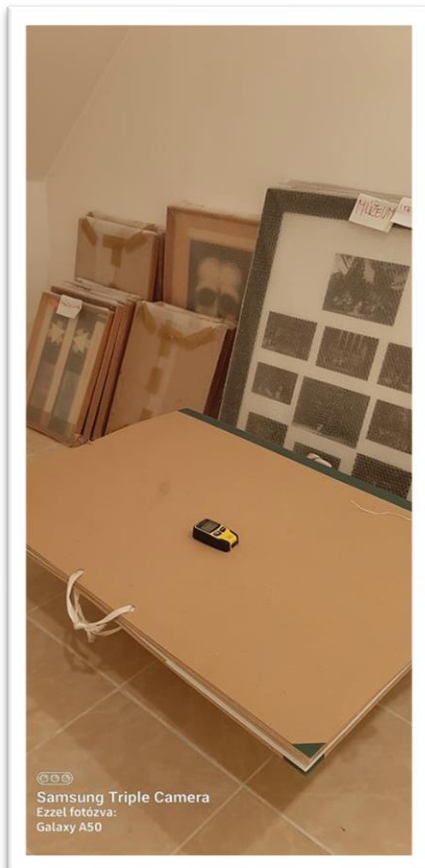

2. TROTEC TTK 72 E PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

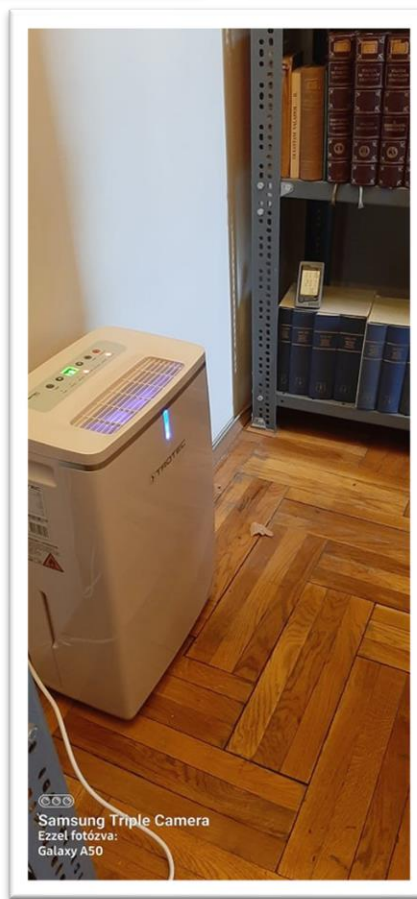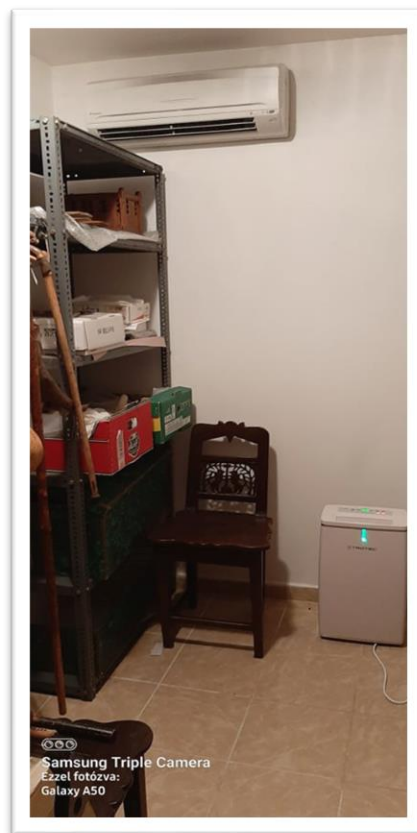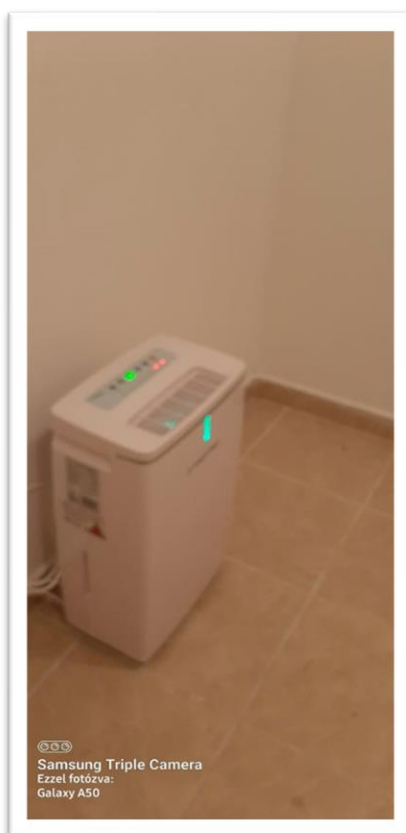

3. ELSEC 765 C KOMBINÁLT MÉRŐMŰSZER ÉS TROTEC BZ 05 PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSEKLET MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

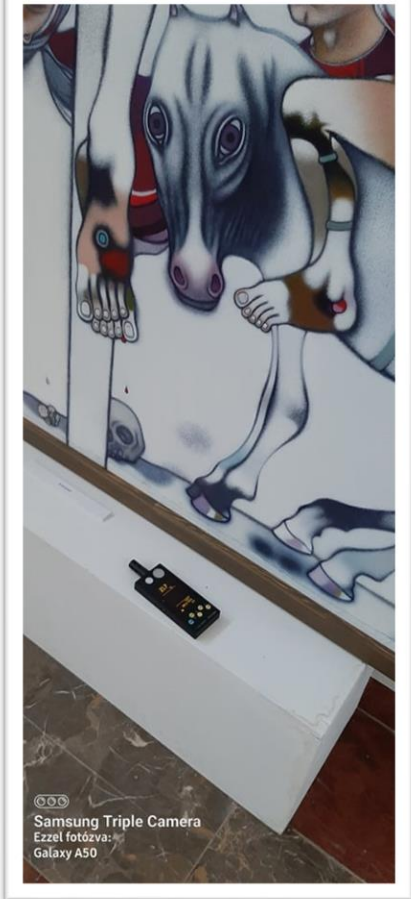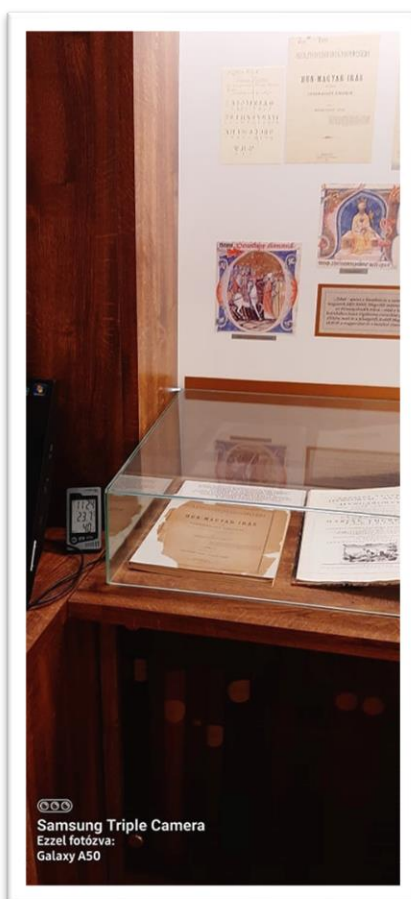

4. FILLA TÁROLÓ- ÉS PANORÁMA I. ALBUMLAPOK



5. ARCHIVÁLÓ DOBOZOK (TYP/II/130 ÉS TYP/II/450) ÉS SAVMENTES SELYEMPAPÍR CSOMAGOLÁSHOZ

